


DentalMonitoring

ご案内資料

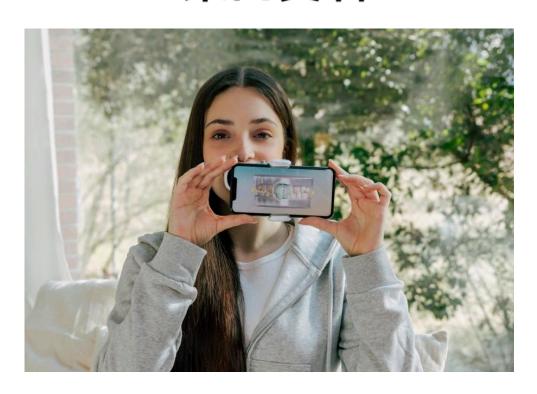

目次

		4
1.	デンタルモニタリングとは	1
2.	アプリのインストールとログイン	1
3.	初期設定の方法	2
4.	スキャンボックスプロの使い方	3
5.	スキャン撮影前の設定方法	4
6.	V2スキャン撮影方法	5
7.	V1スキャン撮影方法	6
8.	スキャン撮影後の対応	7
9.	治療の進捗状況の確認方法	8
0.	その他	9

1.デンタルモニタリングとは

デンタルモニタリングは、歯科治療や矯正治療の 進行状況をリアルタイムで追跡できる革新的なアプリです。アプリを通 じてご担当の歯科医院との連携が強化され、治療計画に沿った最適 なケアが提供されます。このガイドでは、デンタルモニタリングを初め て使用する患者様に向けて、アプリのインストールから治療の進行状 況の確認方法までを詳しくご説明します。

2.アプリのインストールとログイン

※アプリ始動のメールが届かない場合、P.11を参照して下さい。

- 1. デンタルモニタリングから受信したメールを開きます。
- メール文面中のステップ1のDentalMonitoringアプリをダウンロードiPhoneまたはAndroidのうち、該当のURLをクリックします。
- Google PlayもしくはApp Storeよりデンタルモニタリングアプリをインストールします。
- 4. インストール完了後に再びメールに戻り、ステップ2の アカウントにログインする方法を選んでくださいのこの <u>リンクから直接アカウントにアクセス</u>]のURL部分をク リックするとログインが完了します。

*ログイン後にスマートフォンの設定に応じてモバイル データ通信の設定画面が表示される可能性があります。





3.初期設定の方法

- ①資料の確認 内容に問題がなければ [同意する]
- ② オンボード(初期設定)のご案内 オンボードを開始する場合は [続ける]
- ③通知を受け取る時刻設定 通知を受け取る時間を設定し [続ける]
- ④プロフィール写真の設定(※任意) アプリで使用する画像選択し [保存]
- ⑤ ログイン完了の画面 右上[×]で閉じる。






4.スキャンボックスプロの使い方

準備するもの

- スキャンボックスプロ
- チークリトラクターチューブ
- ・スマートフォン
- 鏡(洗面所がおすすめ)
- ティッシュやハンカチ等

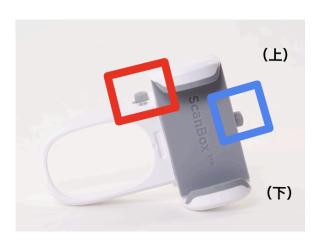



調整ボタン(2ヶ所) *詳細は下図





組み立て図

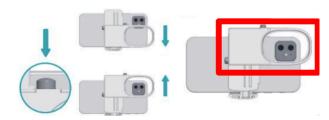

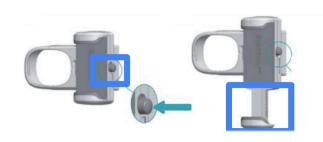

保管方法

- ・使用後、チークリトラクターチューブは中性 洗剤を用いて洗浄することが可能です。
- ・洗浄後は専用のメッシュポーチにスキャン ボックスプロと一緒に保管して下さい。
- ・不具合のある場合は、担当の歯科医院までご連絡下さい。

5.スキャン撮影前の設定方法

1. アプリを開き、ホーム画面に表示されている[スキャンを開始する]を押す。



2. 指示されたスキャン撮影ツールを選択して

[保存]を押す。



4. スキャンボックスプロにスマートフォンを装着。*カバーケースが大きい場合は外します。



6. セッティング完了後、チークリトラクターチューブを歯ぐきに軽く当たる程度までしっかりとくわえます。



7. スマートフォンの画面上で、歯の位置調整をします。


歯が画面の中央にくるようにスキャンボックスプロの上部ボタンを押して上下に、もしくはスマートフォン本体をスライドさせ左右の調整をします。

3. 現在装着のアライナー番号、スキャン設定の内容、音量、(必要に応じて)アダプターの有無を確認。問題なければ最下部の[スキャンを開始する]を押す。

<u>*1 スキャン撮影時にアライナー番号は特別な場合を</u> 除き触らない。



*2「アダプターが必要」と表示されたら、アダプターを装着する。



5. チークリトラクターチューブをスキャンボックスプロに装着します。正しく装着ができるとカチッと音がなります。





6.V2スキャン撮影方法

※スマートフォンとチークリトラクターチューブをしっかりと把持し、音声ガイダンスに従って撮影を行います。

7. 最初は取り外し可能装置を装着したままです。

<u>歯と歯の間を1cm程度少し離した状態</u>で左右 に動かしながら撮影します。

Point: 頭はなるべく動かさず、肩と腕を使って しっかりと奥歯まで映るように撮影します。 奥歯のスポットまで届かない場合は限界の部 位で静止するとスポットが近づいてきます。



8. 取り外し可能装置を外します。 <u>奥歯でしっかりと噛んだ状態</u>で左右に動かし ます。



9. スポットの位置で<u>口を開き、噛み合</u> <u>わせて</u>撮影します。(3箇所)



10. 1種類目と同様に<u>歯と歯の間を1cm程</u> 度少し離した状態で左右に動かします。



11. <u>上下それぞれの噛み合わせ面</u>の撮影です。 チークリトラクターチューブを前歯に当て、歯列全体が 映るように<u>上下に傾けながら</u>撮影します。





*撮影方法についてはアプリ内の チュートリアル[ScanBox proでのス キャン方法]から同様の内容を動画 で確認できます。

7.V1スキャン撮影方法

※スマートフォンとチークリトラクターチューブをしっかりと把持し、音声ガイダンスに従って撮影を行います。 ※画面を2度タップして進めていきます。

- 7. 準備完了後、スマートフォン画面を2度タップしてスキャン撮影開始します。
- 8. 最初は取り外し可能装置を装着したままです。9. 取り外し可能装置を外します。 歯と歯の間を1cm程度少し離した状態で、 左右に動かしながら撮影します。

奥歯でしっかりと噛んだ状態で、 左右に動かしながら撮影します。

Point: 開口の度合いは、青色バーを参照。 頭はなるべく動かさず、肩と腕を使って しっかりと奥歯が映るように撮影します。





10. 1種類目と同様に歯と歯の間を1cm程度 少し離した状態で左右に動かします。



11. 上下それぞれの噛み合わせ面の撮影 です。チークリトラクターチューブを前歯に 当て、歯列全体が映るように上下に傾けな がら撮影します。





*撮影方法についてはアプリ内のチュート リアル[ScanBox proでのスキャン方法]から 動画で確認できます。

8.スキャン撮影後の対応

スキャン撮影終了後、[レビューを開始]ボタンを押して撮影した画像を確認します。 ※画像を確認し、問題がある場合は再撮影して下さい。

12.ステップごとのスキャンのレビューを順番に確認します。

上部:実際に撮影された画像が表示されます。

中部:スキャン撮影時の重要ポイントがリストで表示されます。各項目はデンタルモニタリング 社のAI判定により、問題がある場合は赤色で表示されます(※再撮影必須)。

下部:再撮影を行う場合は[このステップを再度行う]をONにします。問題ない場合は右下の [次へ]を押すと次のスキャンレビューが表示されます。



13.各スキャンレビューの確認終了後、最後に要約の画面が表示されます。 下部の[スキャンを送信]ボタンを押してスキャンデータをアップロードします。


※[スキャン解析中]と表示されるまでアプリは閉じないで下さい。



9.治療の進捗状況の確認方法

アプリのホーム画面の[進捗状況を見る]ボタンを押すと、治療の進捗状況が確認できます。

すべての画像は、初回と最新時のスキャン画像を組み合わせています。左 上のボタンを切り替えると様々な形で比較できます。

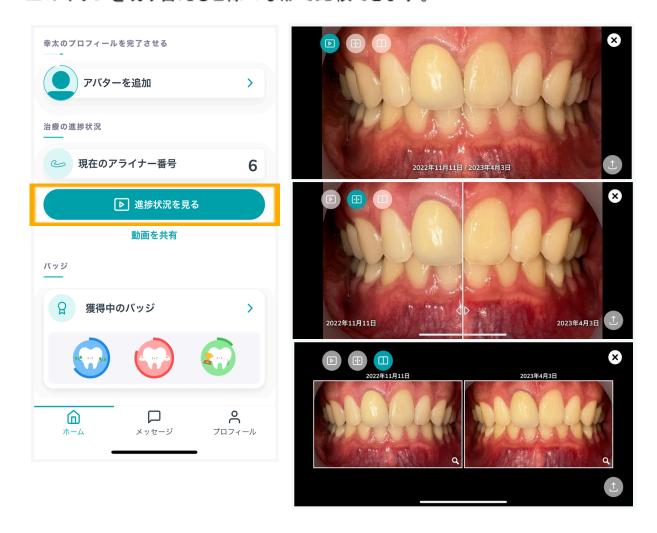

- ・進捗状況のデータは[動画を共有]を押すとSNS等で共有することが可能です。
- ・条件を満たすと、バッジを獲得できます。[獲得中のバッジ]から確認できます。

10.その他

○アプリ使用時のお願い

- 充電確認(60%以上推奨)
- マナーモード・消音を解除
- スマホケースは必要であれば外す
- アプリの更新は「自動」に設定
- アプリのプッシュ通知設定はオン
- ソフトウェアアップデートで常に最新状態にする

(例)iphone



○スキャン撮影中に問題が生じた場合

- <u>音声ガイダンスが英語で流れる:</u>
 アプリ内「プロフィール」>「リソースの更新」をタップすることで日本語に変更できます。
- アプリが変な動きをする: バックグラウンドのアプリを全て閉じて下さい。もしくは、アプリを終了して再起動して下さい。

○スキャン撮影後の結果通知

スキャン撮影後、解析結果が出るまで以下の時間がかかります。 (※解析結果が判明次第、通知が届くため早まる場合があります。)

- アライナー治療:12時間以内
- ブラケットなどアライナー無しの治療:48時間以内
- 3D解析(3Dモニタリング):72時間以内

○スキャン撮影の練習

アプリ内のプロフィール画面より[テストスキャン]を押すと、撮影の練習ができます。※スキャンデータはアップロードされないため解析結果は届きません。

○アプリ始動のメールが届かない場合

「Dental Monitoring」と入力してアプリ検索し、取得します。 [ログインリンクを受け取る]から担当医に提供したEメールアドレスを入力して ください。アカウントにログインするためのリンクが返送されます。













続けてP.2の「初期設定の方法」を参照し、 設定完了させて下さい。

